

**PLUSCONNECT  
Wireless Weight Scale  
UC-350CNBLE**



**Instruction Manual**

Safety Information .....	E-2
Overview .....	E-3
Initial Startup .....	E-4
Connecting to Mobile Device (Pairing) .....	E-5
Start Measuring .....	E-7
Offline Measurement .....	E-9
Select Measurement Unit .....	E-9
Manage Your Health .....	E-10
Troubleshooting .....	E-11
Specifications .....	E-12
Maintenance .....	E-14
Warranty .....	E-15

---

Thank you very much for selecting the A&D Medical PLUSCONNECT Wireless Weight Scale UC-350CNBLE. Please do read the user manual carefully and thoroughly so as to ensure the safe usage of this product, and keep the manual well for further reference in case you have problems.



# Safety Information

## Your Scale and Its Environment

---

**To ensure your safety as well as the service life of your scale, please avoid using the scale under the following circumstances:**

- Slippery floor such as tile floor
- Jumping onto the platform immediately after bath or with wet feet
- Near a cell phone or microwave oven

**Avoid storage in the following locations:**

- Where there is water
- Where the device may be exposed to extreme temperatures, humidity, moisture, direct sunlight, dust, or salt air
- Where there is risk of shock or drop
- Where you store chemicals or full of corrosive gases
- Where in reach of infants or children

## Efficient Use of Your Scale



---

**To ensure the accuracy of measurement, please follow the below instructions when you start the measurement.**

- Place the scale on a flat, hard surface. Soft surface such as carpet will affect the performance of the scale.
- Avoid measurement immediately after strenuous exercise, sauna or bath, drinking, and dining.
- Always start measurement in the same time slot and on the same scale located on the same flat, hard surface.

# Overview

## Device Components



Includes:

- Weight Scale UC-350CNBLE
- 4 x AAA Batteries (1.5V each)
- User Manual
- Quick Start Card

## LCD Display



<b>lb</b>	Pound
<b>kg</b>	Kilogram
	Successful Bluetooth Connection
	Data transmitting/pending to transmit to wireless wellness system
	Low Battery


# Initial Startup

## Insert the Batteries

- Open the battery door in the back of the scale.
- Insert the batteries (4 x 1.5V AAA) into the battery compartment according to the polarity indications marked inside the compartment.
  - \* The digits “000000” will be shown on the LCD.
- Close the battery door and wait until the digits “00” are shown on the LCD.



### CAUTION

- When the symbol  appears, the device will power off. Then you shall replace with a new set of batteries. Please replace all four batteries at the same time. Do NOT mix the old batteries with the new ones.
- Worn batteries are hazardous waste. Do NOT dispose of them together with the household garbage. Please refer to the local ordinances and recycling instructions regarding disposal of the worn batteries and scrapped device.
- If you do not intend to use this unit for a prolonged period of time, it is advisable to remove the batteries before storing.

# Connecting to Mobile Device (Pairing)

Download the “A&D Connect” app

Download the free “A&D Connect” app from the App Store or Google play.



With the advanced *Bluetooth*® 4.0 technology applied, the mobile or portable equipments, which are equipped with *Bluetooth*® function in line with BLE Technical Specifications established by global organization *Bluetooth*® SIG, are capable to receive your personal health data.

## Account Registration and Device Setup

Create your account following the app instruction or continue as a guest.

### Account Registration

Create an account with username and password. The app will save and track data on your account and calculate your BMI



### Guest Mode

Log in as guest user. Reading is saved on device memory but not in your account

In the Device Setup screen, select UC-350BLE to get the app in pairing mode with the scale.


**UC-350BLE**  
weight scale






# Connecting to Mobile Device (Pairing)

## Pair-Up


- Turn on *Bluetooth*® and the app. Make sure both are ON when pair-up is proceeding.
- Press and hold “UNIT” button in the back of the scale to start pair-up.




Symbol  and symbol  will be shown on the scale LCD alternatively, indicating pair-up is proceeding.



On the app, select User ID among P1 to P7.



**NOTE: Remember your “P#” to ensure data is stored under correct User.**

If SUCCEED, symbol  will be shown on the scale LCD.



If FAIL, symbol “E1” will be shown on the LCD. *(Please refer to Troubleshooting for more details.)*



# Start Measuring

## Initializing Your Scale

1. Position the scale on a flat, hard surface. Carpeted or uneven floors may affect accuracy.
2. Press the platform centre and remove your foot.
3. “0.0” will be displayed.
4. The scale will switch off and is now ready for use. This initialization process must be repeated if the scale is moved. At all other times step straight on the scale.



## Setting the User ID and Start Measuring


- Press “SET” button or when the LCD displays 0.0, press and hold “SET” button for about 3s to select your “P#”.
- Once “P1” flashes, press the function button ▲ or ▼ to select your “P#” among P1 to P8. Press “SET” button to lock it. Once the initial User ID is set up, a single user doesn’t have to repeat this process each time because the scale will remember you.



**Be sure to select your “P#” on the scale.  
Guest User should select “P8”.**

*If you forget your “P#”, confirm in the app dashboard.  
Your “P#” is displayed below the scale illustration.*

- After setting your “P#”, step on the platform when the scale displays “0.0”. Stand still and keep full contact with the scale until the unit (lb/kg) stops flashing. Then the weight is locked.



«♪ Beep»



«♪ Beep»



- When your scale is successfully paired with your smartphone and the Bluetooth is ON, it will process data transmission automatically. *(Please refer to Data Transmission for more details.)*









# Start Measuring

## Data Transmission

---

- Once the Weight Scale UC-350CNBLE is successfully paired-up with your smartphone, please open the “A&D Connect” app and turn on your Bluetooth. Keep smartphone and scale in transmission distance. Step on the scale and take a measurement. Once the measurement is finished the data is automatically transferred to the app.
- The symbol  will disappear after successful data transmission, and you may check your personal health data stored in your smartphone.
- If the data is not transmitted to a paired phone, the symbol  will remain. The pending measurement data will be temporarily kept in the scale and transmitted to your smartphone when next connection is complete.



	Data transmitting
	Data ready to transmit to the app: <ul style="list-style-type: none"><li>• If SUCCEED, the symbol disappears;</li><li>• If FAIL, the symbol remains.</li></ul>

Note: When the data transmission is successful, the device will shut down automatically 3 seconds later.

## Multiuser

---

Up to 8 people can use and store readings on the weight scale (*7 registered users and 1 guest can share the scale*).

- To add new users, select User ID that is not assigned already in the Device Setup process on the app (pg. E-5 and E-6). If all 7 User IDs are occupied, you can overwrite one by simply selecting it.
- **Be sure to select the correct “P#” on the app and the scale for each user. Guest Users should select “P8”.**
- Once the correct User ID is selected, follow the steps for *Start Measuring*.

# Offline Measurement

Even when you don't have your phone, the weight data is stored in your ID memory and transmitted next time the scale is connected with your phone (max 30 memory).

**Be sure to select your "P#" on the scale. Guest Users should select "P8".**


1. Step onto the scale platform and remain still while the scale computes your weight. Keep full contact with the scale until the unit (lb/kg) stops flashing.
2. A beep sound will indicate to step off and the scale will display your weight value.
3. The scale will automatically turn off after a few seconds.



# Select Measurement Unit

## Changing Measurement Unit

The default measurement unit is "lb". You may press "UNIT" button on the back of the scale to choose among kilogram and pound.



## CAUTION

- Please put the scale on flat hard ground when finishing the unit selection. Wait for a few seconds, then you may start measuring. If there is not any operation in weighing mode, the scale will turn off in a few seconds.

# Manage Your Health

## Wireless Communication Function

---

This scale uses *Bluetooth*<sup>®</sup> wireless connectivity to communicate with a receiver device. At the end of measurement, the measurement data is sent from this scale to the receiver device.

*Bluetooth*<sup>®</sup> is communication technology that enables devices to communicate wirelessly. The *Bluetooth*<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by A&D is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### Receiver Device

Use with a device such as personal computer or smartphone with an application to enable *Bluetooth*<sup>®</sup> communication with this scale. Download and install the app from Apple or Google.

## Precautions for Wireless Functions

---

### **WARNING**

- Do not use in places where wireless communication is prohibited, such as on airplanes or in hospitals. This scale may have an adverse effect on electronic devices or medical electrical equipment.

### **CAUTION**





- If the communication function of this scale is used near a wireless device that communicates in the 2.4 GHz range, the processing speed of both devices may decrease. Do not use near a microwave oven where a magnetic field, static electricity or radio wave interference may occur. (The signal may not reach due to environmental reasons.)

\* A&D cannot accept any responsibility for any losses incurred such as operating malfunctions or loss of data that may occur through the use of this scale.

\* This scale is not guaranteed to connect to all *Bluetooth*<sup>®</sup> compatible devices.

# Troubleshooting

## Error Prompt

Error	Description	Solution
	Overload. The device will power off.	Stop using this scale for measurement.
	Low Battery. The device will power off.	Replace all four batteries at the same time. Please purchase the authorized batteries for replacement.
	Failure of pairing up your scale with your smartphone. Or failure of activation.	Please check below items: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth is ON.</li> <li>• App is ON.</li> <li>• Both devices are within the transmission distance of Bluetooth.</li> </ul>
	Data fails to upload ( <i>The notebook icon will be displayed.</i> )	Connect to the app to upload the data.

## When Data Transmitting ...

Problem	Root Cause	Solution
Data transmission failed.	Bluetooth is OFF.	Turn ON the Bluetooth via Settings.
	App is OFF.	Press the A&D connect app in your phone and open the dashboard.
	Out of range of Bluetooth transmission.	Place your smartphone closer to the scale.

# Specifications

## Specifications

---

<b>Product Name</b>	Weight Scale (UC-350CNBLE)
<b>Dimension</b>	Scale: 321x321x23.5mm (Approximately)
<b>Net Weight</b>	Approximately 1.98kg ( Excluding the dry cells)
<b>Display</b>	Blue LCD
<b>Measurement Unit</b>	Kilogram / Pound
<b>Measurement Range</b>	5kg to 180kg / 11lb to 400lb
<b>Division</b>	0.1kg / 0.2lb
<b>Accuracy</b>	5-50kg: $\pm 0.3\text{kg}$ ; 50-100kg: $\pm 0.4\text{kg}$ ; 100-150kg: $\pm 0.5\text{kg}$ ; 150-180kg: $\pm 0.7\text{kg}$ ;
<b>Working Environment</b>	Temperature: 5°C to 40°C Relative humidity: $\leq 85\%RH$ Atmospheric pressure: 86kPa to 106kPa
<b>Storage Environment</b>	Temperature: -20°C to 60°C Relative humidity: 10%RH to 93%RH Atmospheric pressure: 50kPa to 106kPa
<b>Power Source</b>	6V (Four AAA-size Batteries)
<b>Auto-ON</b>	SENSE ON technology
<b>Auto-OFF</b>	About 10 seconds while showing 0.0 About 10 seconds when the weight is locked About 10 seconds when the weight is unstable.
<b>Accessories</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Four AAA-size Batteries</li><li>• User Manual</li></ul>

### About the Accuracy of This Product

\* This product passes strict inspection before delivery and therefore its accuracy is guaranteed by the manufacturer. Please refer to the above table for the descriptions on accuracy.

\* This product is specially designed for body scale as well as weight measurement. It should NOT be used by anyone during the process of transaction for verification of goods' weight.

# Specifications

## FCC CAUTION

---

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that it deemed to comply without maximum permissive exposure evaluation (MPE). But it is desirable that it should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from a person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Maintenance

## Maintenance

---

When carrying out usual maintenance, please ensure practice of the following Do's and Don'ts:

- DO use a dry soft cloth to wipe the dust.
- DO use a wet soft cloth, dipped into water and wrung out, to wipe the dirt. Then use a dry soft cloth to dry up the device.
- DON'T wash the device with water or immerse it in water.
- DON'T use propellant, abrasive or other chemicals to wipe the dirt in avoidance of discolor or malfunction.
- DON'T disassemble this device. If you have any problems, please contact A&D Medical. *(Please refer to Warranty for contact information)*
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Remove the batteries if the scale will not be used for a long period.

# Warranty

## LIMITED 2 YEAR WARRANTY—A&D Medical Weight Scale

---

A&D Medical (“A&D”) warrants to the first purchaser (“You”) that the A&D product You purchased (the “Product”) will be free from defects in material, workmanship and design for the applicable Warranty Term stated above from the date You purchased the Product under normal use. This Limited Warranty is personal to You and is not transferable. If the Product is defective, then (i) if You are a Consumer, You return the Product to the retailer You purchased it from (if within such retailer’s return time frame) or You return it to A&D in accordance with the procedure set forth below, or (ii) if You are NOT a Consumer, You return the Product to A&D in accordance with the procedure set forth below. A&D’s warranty obligation is limited to the repair or replacement, at A&D’s option, of the defective Product that has been returned by You within the warranty period. Such repair or replacement will be at no charge to You. The repaired or replacement Product is warranted hereunder for the longer of the remainder of the original warranty period or 90 days from the date of shipment of the repaired or replacement Product. If you return the Product for warranty service to A&D, You must return the Product, freight and insurance prepaid, within the warranty period to the address set forth below, together with satisfactory proof of the date of Your purchase (such as a sales receipt or statement of online warranty registration) and a description of the defect. Also please enclose a check for return shipping and insurance of the Product, as provided to you by the customer service representative.

### **In US**

A&D Medical  
Attn.: Warranty Department  
1756 Automation Parkway  
San Jose, CA 95131  
1-800-726-3364

### **In Canada**

Auto Control Medical  
Attn.: Warranty Department  
6695 Millcreek Dr., Unit 6  
Mississauga, ON, L5N 5R8  
1-800-461-0991



# Warranty

This Limited Warranty does not cover, and A&D will not be liable for (i) any shipment damage, (ii) any damage or defect due to misuse, abuse, failure to use reasonable care, failure to follow written instructions enclosed with the Product, accident, subjecting the Product to any voltage other than the specified voltage, improper environmental conditions, or modification, alteration or repair by anyone other than A&D or persons authorized by A&D, or (iii) expendable or consumable components.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY PROVIDED BY A&D; THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. If A&D cannot reasonably repair or replace the Product, A&D will refund the amount You paid for the Product (not including taxes), less a reasonable charge for usage. To receive a refund you must have returned the Product and all associated materials to A&D.

The above remedy of repair, replacement or refund is your only and exclusive remedy. IN NO EVENT SHALL A&D BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, LOST INFORMATION OR REPLACEMENT COSTS, ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF A&D HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so that the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state.

No distributor, dealer or other party is authorized to make any warranty on behalf of A&D or to modify this warranty, or to assume for A&D any liability with respect to its products.

*Bluetooth*® devices carry the *Bluetooth*® logo mark.

iPhone, iPad and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google and Google logo are registered trademarks of Google, Inc.



**Balance sans fil  
PLUSCONNECT  
UC-350CNBLE**



**Manuel d'utilisation**

Informations de sécurité .....	F-2
Vue d'ensemble .....	F-3
Premier démarrage .....	F-4
Connexion à un appareil mobile (jumelage) .....	F-5
Commencer à mesurer .....	F-7
Mesures hors ligne .....	F-9
Sélection de l'unité de mesure .....	F-9
Gestion de votre santé.....	F-10
Dépannage .....	F-11
Caractéristiques techniques .....	F-12
Entretien .....	F-14
Garantie .....	F-15

---

Merci beaucoup d'avoir choisi la balance sans fil A&D Medical PLUSCONNECT UC-350CNBLE. Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce manuel d'utilisation afin de garantir un usage sûr de ce produit, et conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de problème.



# Informations de sécurité

## Votre balance et son environnement

---

**Afin de préserver votre sécurité et la durée de vie de votre balance, évitez de l'utiliser dans les situations suivantes :**

- Sol glissant, plancher carrelé par exemple
- Juste après un bain ou avec les pieds mouillés
- À proximité d'un téléphone portable ou d'un four à micro-ondes

**Évitez de ranger la balance dans les conditions suivantes :**

- En présence d'eau
- Là où l'appareil pourrait être exposé à des températures extrêmes, de l'humidité, de la moisissure, de la poussière, de l'air salin ou la lumière directe du soleil
- En cas de risque de choc ou de chute
- Là où des produits chimiques sont stockés ou en présence de gaz corrosifs
- À portée d'enfants ou de nourrissons

## Utilisation efficace de votre balance


---

**Pour assurer la précision de la mesure, veuillez suivre les instructions suivantes pour commencer la mesure.**

- Posez la balance sur une surface plane et solide. Les surfaces molles, comme le tapis, ont un impact sur les performances de la balance.
- Évitez de vous peser juste après un exercice physique intense, un sauna ou un bain ou juste après avoir bu ou mangé.
- Lancez toujours vos mesures vers la même heure et sur la même balance posée sur la même surface plane et solide.

# Vue d'ensemble


## Composants de l'appareil



Inclus :

- Balance UC-350CNBLE
- 4 x piles AAA (1,5 V chacune)
- Manuel d'utilisation
- Fiche de démarrage rapide

## Affichage à cristaux liquides



<b>lb</b>	Livres
<b>kg</b>	Kilogrammes
<b>(((•)))</b>	Connexion Bluetooth réussie
<b>☰</b>	Données en cours de transmission ou en attente de transmission vers le système Wellness sans fil
<b>🔋</b>	Pile faible


# Premier démarrage

## Insertion des piles

- Ouvrez le couvercle des piles au dos de la balance.
- Insérez les piles (4 x 1,5 V AAA) dans le compartiment à piles, en respectant les polarités indiquées dans le compartiment.  
\* Les chiffres « 888888 » s'affichent sur l'écran ACL.
- Fermez le couvercle des piles et attendez que les chiffres « 00 » s'affichent sur l'écran ACL.



### ATTENTION

- L'appareil s'éteint après l'apparition du symbole . Vous devez alors remplacer les piles existantes par des piles neuves. Veuillez remplacer les quatre piles à la fois. N'UTILISEZ PAS des piles anciennes en même temps que des piles neuves.
- Les piles usagées constituent des déchets dangereux. NE LES ÉLIMINEZ PAS avec le reste des déchets domestiques. Veuillez vous référer aux réglementations et consignes de recyclage locales pour l'élimination des piles usagées et de l'appareil.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser cet appareil pendant une longue période, il est conseillé de retirer les piles avant de ranger l'appareil.

# Connexion à un appareil mobile (jumelage)

## Téléchargement de l'application « A&D Connect »

Téléchargez l'application « A&D Connect » gratuite du App Store ou de Google Play.




Grâce à la technologie *Bluetooth*<sup>MD</sup> 4.0 avancée, les appareils mobiles et portables équipés d'une fonction *Bluetooth*<sup>MD</sup> conforme aux caractéristiques techniques BLE établies par l'organisme international *Bluetooth*<sup>MD</sup> SIG sont en mesure de recevoir vos données de santé personnelles.

## Enregistrement d'un compte et configuration de l'appareil

Créez votre compte en suivant les instructions de l'application, ou continuez en tant qu'invité.

**Enregistrement d'un compte :** créez un compte en saisissant un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'application enregistrera et suivra les données de votre compte et calculera votre IMC.



**Mode Invité :** connectez-vous en tant qu'utilisateur invité. Les relevés sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil, mais pas dans votre compte.

Dans l'écran Device Setup (Configuration de l'appareil), sélectionnez UC-350BLE pour que l'application entre en mode Jumelage avec la balance.

Balance  
UC-350BLE







# Connexion à un appareil mobile (jumelage)

## Jumelage

- Activez le *Bluetooth*<sup>MD</sup> et démarrez l'application. Assurez-vous que le *Bluetooth*<sup>MD</sup> reste activé et l'application reste lancée pendant le jumelage.
- Maintenez enfoncé le bouton UNIT (unité) au dos de la balance pour démarrer le jumelage.




Les symboles 0<sup>0</sup> et 0<sup>0</sup> sont affichés en alternance sur l'écran ACL de la balance pour indiquer que le jumelage est en cours.



Dans l'application, sélectionnez un nom d'utilisateur entre P1 et P7.

**REMARQUE : prenez note de votre « P# » pour vous assurer que les données sont enregistrées pour le bon utilisateur.**

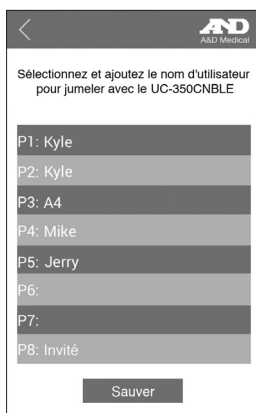

En cas de RÉUSSITE de l'opération, le symbole [ ] s'affiche sur l'écran ACL de la balance.



En cas d'ÉCHEC, le symbole « E1 » s'affiche sur l'écran ACL.  
(Reportez-vous à la section *Dépannage pour plus d'informations.*)



# Commencer à mesurer

## Initialisation de la balance


1. Posez la balance sur une surface plane et solide. Le tapis et les sols irréguliers peuvent affecter la précision.
2. Appuyez sur le centre de la plateforme et retirez votre pied.
3. « 0.0 » est affiché.
4. La balance s'éteint et est maintenant prête à être utilisée.



Cette procédure d'initialisation doit être répétée si la balance est déplacée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez monter directement sur la balance.

## Réglage du nom de l'utilisateur et début de la mesure


- Appuyez sur le bouton SET (réglage), ou, quand l'écran ACL affiche 0.0, maintenez le bouton SET enfoncé pendant environ 3 secondes pour sélectionner votre « P# ».
- Quand « P1 » clignote, appuyez sur le bouton de fonction ▲ ou ▼ pour sélectionner votre « P# » pouvant aller de P1 à P8. Appuyez sur le bouton SET (réglage) pour le conserver. Une fois le P# initial configuré, l'utilisateur n'est pas obligé de répéter cette procédure à chaque fois, car la balance se souviendra de lui.



**Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».**

*Si vous oubliez votre « P# », consultez le tableau de bord de l'application pour le retrouver. Votre « P# » est affiché sous l'illustration de la balance.*

- Après avoir défini votre « P# », montez sur la plateforme quand la balance affiche « 0.0 ». Restez immobile et maintenez le contact avec la balance jusqu'à ce que l'unité (lb/kg) cesse de clignoter. Le poids est alors bloqué.



« Bip »



« Bip »



- Quand la balance a bien été jumelée avec votre téléphone intelligent et que le Bluetooth est activé, les données sont transmises automatiquement. (Reportez-vous à la section *Transmission des données pour plus d'informations.*)





# Commencer à mesurer



## Transmission des données

- Quand la balance UC-350CNBLE a bien été jumelée avec votre téléphone intelligent, ouvrez l'application « A&D Connect » et activez la fonction Bluetooth. Tenez le téléphone intelligent et la balance à une distance adaptée à la transmission des données. Montez sur la balance et faites une mesure. Une fois la mesure terminée, les données sont automatiquement transmises à l'application.



- Le symbole  disparaît une fois la transmission des données réussie, et vous pouvez consulter vos données de santé personnelles enregistrées sur votre téléphone intelligent.

- Si les données ne sont pas transmises à un téléphone jumelé, le symbole  reste affiché. Les données de mesure en attente seront temporairement conservées dans la balance et seront transmises à votre téléphone intelligent lors de la prochaine connexion.

	Données en cours de transmission
	Données prêtes à être transmises à l'application : <ul style="list-style-type: none"><li>• en cas de RÉUSSITE, le symbole disparaît;</li><li>• en cas d'ÉCHEC, il reste affiché.</li></ul>

Remarque : l'appareil s'éteint automatiquement 3 secondes après la transmission réussie des données.

## Utilisateurs multiples

Jusqu'à 8 personnes peuvent utiliser et stocker des relevés dans la balance (7 utilisateurs enregistrés et 1 invité peuvent se partager la balance).

- Pour ajouter de nouveaux utilisateurs, sélectionnez un ID utilisateur n'étant pas encore attribué en suivant la procédure de configuration de l'appareil de l'application (voir pages E-5 et E-6). Si les 7 noms d'utilisateur sont pris, vous pouvez en remplacer un en le sélectionnant.
- **Assurez-vous de sélectionner le bon « P# » dans l'application et sur la balance pour chaque utilisateur. Les utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».**
- Une fois le bon nom d'utilisateur sélectionné, suivez la procédure décrite dans la section *Commencer à mesurer*.

# Mesures hors ligne

Si vous n'avez pas votre téléphone sur vous, les données de pesée sont enregistrées dans la mémoire de votre ID et seront transmises lors de la prochaine connexion entre la balance et votre téléphone (30 mesures en mémoire maximum).

**Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».**


1. Montez sur la plateforme et restez immobile pendant que la balance calcule votre poids. Maintenez le contact avec la balance jusqu'à ce que l'unité (lb/kg) cesse de clignoter.
2. Un bip se fait entendre pour vous demander de descendre, et votre poids s'affiche sur la balance.
3. La balance s'éteint automatiquement après quelques secondes.



## Sélection de l'unité de mesure

### Changer l'unité de mesure

L'unité de mesure par défaut est « lb ». Vous pouvez appuyer sur le bouton UNIT (unité) au dos de la balance pour choisir entre les kilogrammes et les livres.



### ATTENTION

- Posez la balance sur une surface plane et solide après avoir sélectionné une unité. Attendez quelques secondes avant de commencer à vous peser. En l'absence d'activité en mode Pesée, la balance s'éteint après quelques secondes.

# Gestion de votre santé

## Fonction de communication sans fil

---

Cette balance est équipée de la connectivité sans fil *Bluetooth<sup>MD</sup>* permettant de communiquer avec un appareil de réception. Après la pesée, la balance envoie les données recueillies à l'appareil de réception.

Le *Bluetooth<sup>MD</sup>* est une technologie de communication permettant aux appareils de communiquer sans connexion filaire. Les logos et la marque *Bluetooth<sup>MD</sup>* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par A&D est soumise à une licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

### Appareil de réception

Utilisez un appareil tel qu'un ordinateur personnel ou un téléphone intelligent et installez-y l'application pour permettre la communication *Bluetooth<sup>MD</sup>* avec cette balance. Téléchargez et installez l'application auprès d'Apple ou de Google.

## Précautions relatives aux fonctions sans fil

---

### AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser dans des lieux interdisant la communication sans fil, comme les avions ou les hôpitaux. Cette balance peut causer des interférences nuisibles avec les appareils électroniques ou les équipements électriques médicaux.

### ATTENTION





- Si la fonction de communication de cette balance est utilisée à proximité d'un appareil sans fil communiquant sur une fréquence de 2,4 GHz, la vitesse de traitement des deux appareils peut diminuer. N'utilisez pas la balance à proximité d'un four à micro-ondes. Cela risquerait de provoquer des interférences au niveau du champ magnétique, de l'électricité statique ou des ondes radio. *(Le signal peut être interrompu en raison de l'environnement.)*

\* A&D n'endosse aucune responsabilité en cas de pertes encourues (dysfonctionnements, pertes de données, etc.) susceptibles de se produire lors de l'utilisation de cette balance.

\* Rien ne garantit que cette balance puisse se connecter à tous les appareils compatibles *Bluetooth<sup>MD</sup>*.

# Dépannage

## Message d'erreur

Erreur	Description	Solution
	Surcharge. L'appareil va s'éteindre.	Cessez d'utiliser cette balance pour la pesée.
	Pile faible. L'appareil va s'éteindre.	Remplacez les quatre piles à la fois. Procurez-vous des piles adaptées pour effectuer le remplacement.
	Échec du jumelage de la balance avec votre téléphone intelligent, ou échec de l'activation.	Veillez vérifier les facteurs suivants : <ul style="list-style-type: none"><li>• Le Bluetooth est activé.</li><li>• L'application est lancée.</li><li>• Les deux appareils sont suffisamment près pour permettre la transmission de données via une connexion Bluetooth.</li></ul>
	Échec de téléchargement des données ( <i>l'icône bloc-notes est affichée.</i> )	Connectez-vous à l'application pour télécharger les données.

## Pendant la transmission des données...

Problème	Origine du problème	Solution
Échec de la transmission des données.	Le Bluetooth est désactivé.	Activez le Bluetooth dans les paramètres.
	L'application n'est pas ouverte.	Appuyez sur l'icône de l'application A&D Connect de votre téléphone et ouvrez le tableau de bord.
	Hors de portée de la transmission via Bluetooth.	Rapprochez votre téléphone intelligent de la balance.

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques techniques

<b>Nom du produit</b>	Balance (UC-350CNBLE)
<b>Dimensions</b>	Balance : 321x321x23,5 mm (environ)
<b>Poids net</b>	1,98 kg environ (sans compter les piles)
<b>Écran</b>	Affichage à cristaux liquides (LCD) bleu
<b>Unité de mesure</b>	Kilogramme/livre
<b>Échelle des mesures</b>	5 kg à 180 kg / 11 lb à 400 lb
<b>Division</b>	0,1 kg / 0,2 lb
<b>Précision</b>	5-50 kg : $\pm 0,3$ kg; 50-100 kg : $\pm 0,4$ kg; 100-150 kg : $\pm 0,5$ kg; 150-180 kg : $\pm 0,7$ kg.
<b>Conditions environnementales d'utilisation</b>	Température : 5 °C à 40 °C Humidité relative : $\leq 85$ % HR Pression atmosphérique : 86 kPa à 106 kPa
<b>Conditions environnementales de rangement</b>	Température : -20 °C à 60 °C Humidité relative : 10 % à 93 % HR Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa
<b>Alimentation</b>	6 V (quatre piles AAA)
<b>Allumage automatique</b>	Technologie SENSE ON
<b>Extinction automatique</b>	Environ 10 secondes quand 0.0 est affiché Environ 10 secondes quand le poids est bloqué Environ 10 secondes quand le poids est instable
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quatre piles AAA</li><li>• Manuel d'utilisation</li></ul>

### À propos de la précision de ce produit

\* Ce produit a fait l'objet de contrôles rigoureux avant sa livraison. Sa précision est donc garantie par le fabricant. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessus pour plus d'informations sur sa précision.

\* Ce produit est spécifiquement conçu pour être utilisé comme une balance personnelle et pour peser des poids. Il ne doit PAS être utilisé durant une transaction pour vérifier le poids de marchandises.

# Caractéristiques techniques

## MISE EN GARDE RELATIVE AUX NORMES FCC

---

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ne pas co-implanter ni utiliser cet émetteur conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations définies par la FCC pour un environnement non contrôlé, ainsi que les directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC présentées dans l'annexe C de la norme OET65.

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiations définies par l'IC pour un environnement non contrôlé, ainsi que la directive RSS-102 des normes d'exposition aux radiofréquences (RF) de l'IC. Cet équipement émet un niveau très faible d'énergie RF considéré comme conforme suite à une évaluation de l'exposition maximale admissible (EMA). Toutefois, il est préférable d'installer et d'utiliser l'appareil en maintenant l'émetteur à au moins 20 cm du corps humain (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds, chevilles).

Remarque : cet équipement a été testé et considéré comme conforme aux limites définies pour un appareil numérique de classe B, comme défini par l'article 15 des règles de la FCC.

L'objectif de ces limites est de fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles sur une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucun élément ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférence sur une installation particulière.

Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception de télévision ou de radio, que vous pouvez déterminer en allumant l'équipement puis en l'éteignant, essayez de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des étapes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une autre prise ou un autre circuit que celui auquel le récepteur est relié.
- Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien TV/ radio expérimenté.



# Entretien

## Entretien

---

Pendant les opérations d'entretien courantes, veillez à tenir compte de la liste suivante de choses à faire et à ne pas faire :

- UTILISER un chiffon doux et sec pour dépoussiérer l'appareil.
- UTILISER un chiffon doux et humide, trempé dans l'eau puis essoré, pour enlever la saleté. Puis, utiliser un chiffon doux et sec pour sécher l'appareil.
- NE PAS laver l'appareil à l'eau, et ne pas le plonger dans de l'eau.
- NE PAS utiliser d'essence, d'agent abrasif ou tout autre produit chimique pour enlever la saleté; risque de décoloration ou de dysfonctionnement.
- NE PAS désassembler cet appareil. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter A&D Medical. (*Reportez-vous à la section Garantie pour obtenir les coordonnées.*)
- NE PAS jeter les piles dans un feu. Elles pourraient fuir ou exploser. Retirez les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.

# Garantie

## **GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS – Balance A&D Medical**

---

A&D Medical (« A&D ») garantit au premier acheteur (« Vous ») que le produit A&D que vous avez acheté (le « Produit ») est exempt de défauts de matériaux, de main-d'œuvre et de conception pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessus, à partir de la date d'achat du produit et dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie limitée est personnelle et n'est pas transférable. Si le Produit est défectueux, vous pouvez alors (i) si vous êtes un consommateur, le retourner au revendeur auquel vous l'avez acheté (dans la limite du délai de retour autorisé par le revendeur), ou le retourner à A&D en suivant la procédure exposée ci-après ou, (ii) si vous n'êtes PAS un consommateur, vous pouvez retourner le produit à A&D en suivant la procédure exposée ci-après. L'obligation de garantie d'A&D est limitée à la réparation ou au remplacement, à son entière discrétion, du Produit défectueux retourné par vos soins pendant la période de garantie. Cette réparation ou ce remplacement sera effectué(e) gratuitement. Le Produit réparé ou remplacé est couvert pour le reste de la période de garantie initiale ou pendant 90 jours à compter de sa date d'expédition. Pour bénéficier d'un service sous garantie, vous devez retourner le Produit à A&D, fret et assurance payés d'avance, pendant la période de garantie, à l'adresse indiquée ci-dessous, en joignant une preuve satisfaisante de la date d'achat (p. ex. reçu de caisse ou déclaration d'enregistrement de la garantie en ligne), ainsi qu'une description du défaut. Veuillez également inclure un chèque pour le fret et l'assurance de retour, comme indiqué par le représentant du service à la clientèle.

### **Aux É.-U.**

A&D Medical  
Attn.: Warranty Department  
1756 Automation Parkway  
San Jose, CA 95131  
1-800-726-3364

### **Au Canada**

Auto Control Médical  
Attn.: Warranty Department  
6695 Millcreek Dr., Unit 6  
Mississauga, ON, L5N 5R8  
1-800-461-0991

# Garantie

La présente garantie limitée ne couvre pas, et en cela la responsabilité d'A&D ne saurait être engagée, (i) tout dommage lié à l'expédition, (ii) tout dommage ou défaut dû à une mauvaise utilisation, à un abus, à un manquement au devoir de diligence raisonnable, au non-respect des instructions écrites fournies avec le Produit, à un accident, à l'exposition du Produit à une tension différente de la tension spécifiée, à des conditions environnementales inappropriées ou à une modification, altération ou réparation effectuée par une personne autre qu'A&D ou les personnes autorisées par ses soins, et (iii) les accessoires ou consommables.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE OFFERTE PAR A&D; AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE N'EST ACCORDÉE. Si A&D n'est pas en mesure de réparer ou remplacer raisonnablement le Produit, l'entreprise remboursera le montant que vous avez versé pour l'achat du Produit (taxes non incluses) duquel elle déduira des frais d'utilisation raisonnables. Pour bénéficier d'un remboursement, vous devez avoir retourné le Produit et tous les documents associés à A&D. Le recours susmentionné de réparation, remplacement ou remboursement est votre seul et unique recours. A&D NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, NOTAMMENT DE LA PERTE DE PROFITS, DE LA PERTE D'INFORMATIONS OU DES FRAIS DE REMPLACEMENT, DÉCOULANT DE VOTRE UTILISATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, NOTAMMENT LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, MÊME SI A&D A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Aucun distributeur, revendeur ou autre partie n'est autorisé(e) à accorder une garantie au nom d'A&D, à modifier la présente garantie ou à assumer pour le compte d'A&D une quelconque responsabilité en relation avec ses produits.

Les appareils compatibles *Bluetooth*<sup>MD</sup> portent le logo *Bluetooth*<sup>MD</sup>.

Les marques iPhone, iPad et iPod sont des marques de commerce d'Apple inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google et le logo Google sont des marques déposées de Google inc.



A&D Medical

Manufactured by:

*(Fabriqué par)*

**A&D Company, Limited**

1-243 Asahi, Kitamoto-shi,

Saitama, 364-8585 Japan

[www.aandd.jp](http://www.aandd.jp)

[81] (48) 593-1119

Manufactured for:

*(Fabriqué pour)*

**A&D Engineering, Inc.**

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131 U.S.A.

[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)

1-888-726-9966

Distributed by:

*(Distribué par)*

**Auto Control Médical**

6695 Millcreek Dr., Unit 6

Mississauga, ON, L5N 5R8 Canada

[www.lifesourcecanada.com](http://www.lifesourcecanada.com)

1-800-461-0991